

REVIN BRIELLE

Meet- en regeltechniek

Revision of instruments


TESTRAPPORT

Rapport nummer 3

	<u>Testinstrument</u>	<u>Instrument</u>
Instr.nummer	2276854	171601747
Fabrikaat	Wika	AB
Omschrijving	Digi Testmanometer	Manometer
Meetbereik	0-40 bar	0-25 bar
Klasse	0.1	1.0
Klant	TSH vakopleiding	
Getest door	B. Sewkaransing	

Meetpunten	Range Meetwaarde		Meetwaarde	Meetfout %	
	Bar	Stijgend		Dalend	Stijgend
1	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
2	5,00	5,00	5,06	0,000	0,240
3	10,00	9,94	9,99	-0,240	-0,040
4	15,00	14,92	14,98	-0,320	-0,080
5	20,00	19,90	19,99	-0,400	-0,040
6	25,00	24,95	24,95	-0,200	-0,200

Getest volgens DIN en 837-1: 1997

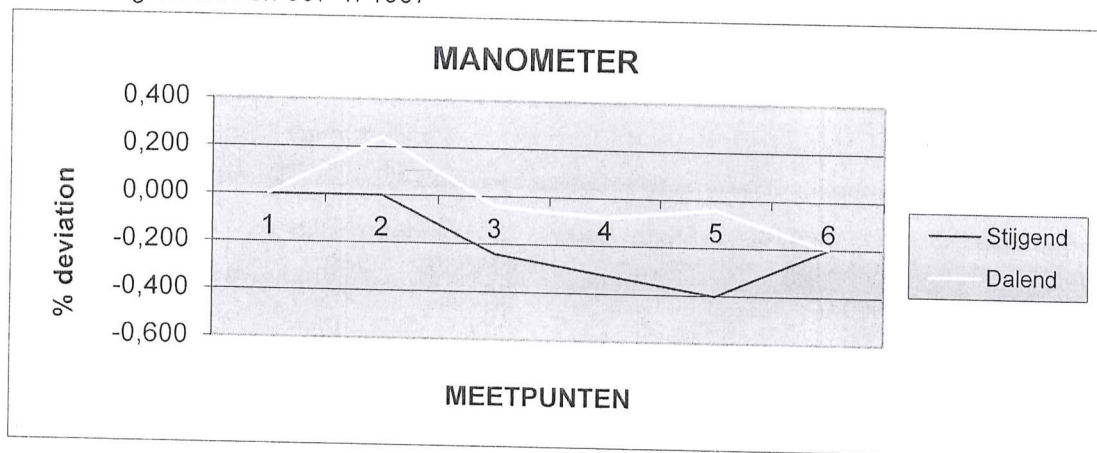

Datum 02-01-25
Ref. klant keuring
Ref. Revin 20240909

REVIN BRIELLE B.V.
't Woud 16
3222 LN Brielle
Tel: 0181-413094
e-mail: info@revinbrielle.com

Revin Brielle B.V. - Industrieterrein 't Woud 16, 3222 LN Brielle
Tel. (0181) 41 30 94 - E-mail info@revinbrielle.com - www.revinbrielle.com
Bank: Rabo. Rekeningnr. IBAN NR NL45RABO0344868680 - K.v.K. Rotterdam 24237422