


TESTRAPPORT

Rapport nummer 3

	<u>Testinstrument</u>	<u>Instrument</u>
Instr.nummer	2276854	192105135
Fabrikaat	Wika	Armano
Omschrijving	Digi Testmanometer	Manometer
Meetbereik	0-40 bar	0-25 bar
Klasse	0.1	1.0
Klant	TSH vakopleiding	
Getest door	B. Sewkaransing	

Meetpunten	Range Meetwaarde		Meetwaarde		Meetfout %	
	Bar	Stijgend	Dalend	Stijgend	Dalend	
1	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
2	5,00	5,02	5,11	0,080	0,440	
3	10,00	10,03	10,10	0,120	0,400	
4	15,00	15,04	15,12	0,160	0,480	
5	20,00	20,08	20,14	0,320	0,560	
6	25,00	25,16	25,16	0,640	0,640	

Getest volgens DIN en 837-1: 1997

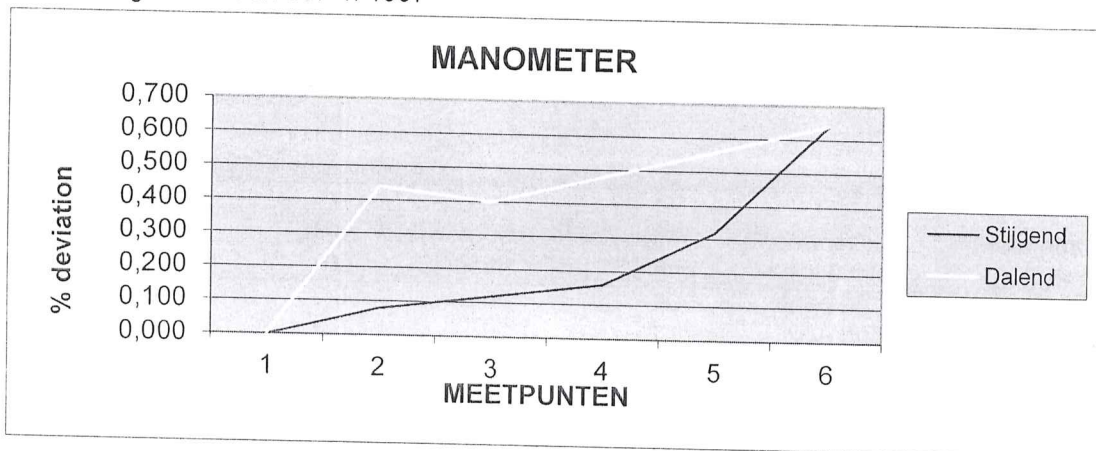

Datum 02-01-25
Ref. klant keuring
Ref. Revin 20240909

REVIN BRIELLE B.V.
't Woud 16
3232 LN Brielle
Tel: 0181-413094
e-mail: info@revinbrielle.com

Revin Brielle B.V. - Industrieterrein 't Woud 16, 3232 LN Brielle
Tel. (0181) 41 30 94 - E-mail info@revinbrielle.com - www.revinsbrielle.com
Bank: Rabo. Rekeningnr. IBAN NR NL45RABO0344868680 - K.v.K. Rotterdam 24237422