

REVIN BRIELLE

Meet- en regeltechniek

Revision of instruments


TESTRAPPORT

Rapport nummer 2

	<u>Testinstrument</u>	<u>Instrument</u>
Instr.nummer	2276942	M336110-13
Fabrikaat	Wika	Revin
Omschrijving	Digi Testmanometer	Manometer
Meetbereik	0-2,5 bar	0-2,5 bar
Klasse	0.1	1.0
Klant	TSH Vakopleiding bv	
Getest door	B. Sewkaransing	

Meetpunten	Range Meetwaarde		Meetwaarde		Meetfout %	
	Bar	Stijgend	Dalend	Stijgend	Dalend	
1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2	0,500	0,496	0,523	-0,160	0,920	
3	1,000	0,998	1,014	-0,080	0,560	
4	1,500	1,497	1,513	-0,120	0,520	
5	2,000	1,991	2,008	-0,360	0,320	
6	2,500	2,493	2,493	-0,280	-0,280	

Getest volgens DIN en 837-1: 1997

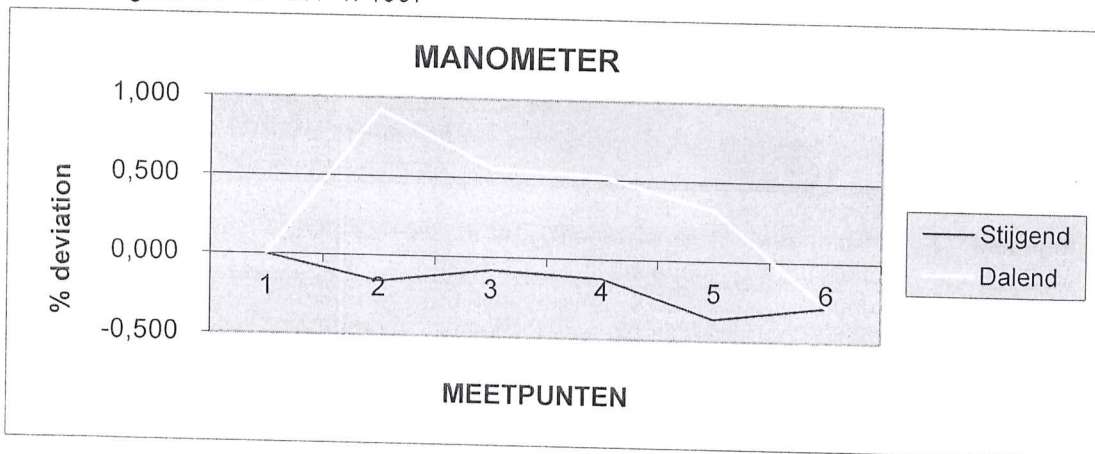

Datum 02-01-25
Ref. klant keuring
Ref. Revin 20240909

REVIN BRIELLE B.V.
't Woud 16
3232 LN Brielle
Tel: 0181-413094
e-mail: info@revinbrielle.com

Revin Brielle B.V. - Industrieterrein 't Woud 16, 3232 LN Brielle
Tel. (0181) 41 30 94 - E-mail info@revinbrielle.com - www.revinbrielle.com
Bank: Rabo. Rekeningnr. IBAN NR NL45RABO0344868680 - K.v.K. Rotterdam 24237422

Op alle opdrachten aan ons, op al onze offertes en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden voor de Metaalnijverheid (SMECOMA VOORWAARDEN), gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder no. 5325 zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst die voor de eerste maal werd gedeponeerd op 30 juni 1950 doch sindsdien enige malen is aangevuld en gewijzigd.